



平成23年精度管理調査報告 臨床化学

市立四日市病院
渡邊愛子


グルコース 測定方法別施設数

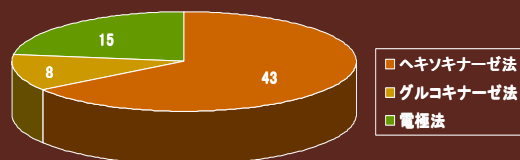


グルコース 測定方法別

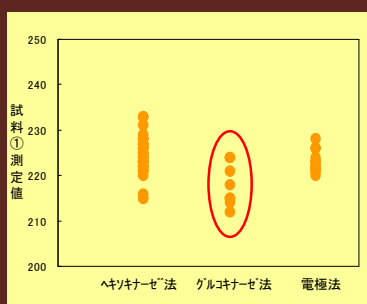


グルコース 試薬メーカー別

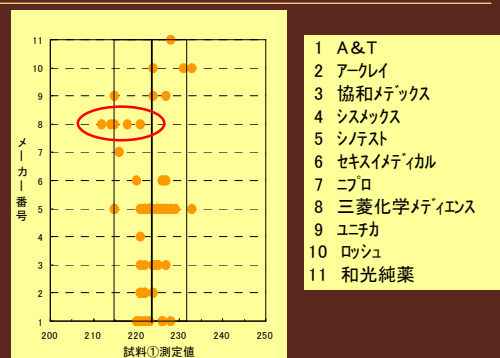


酵素活性測定体系

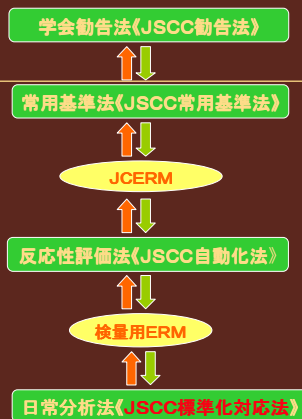

JSCC標準化対応法採用率

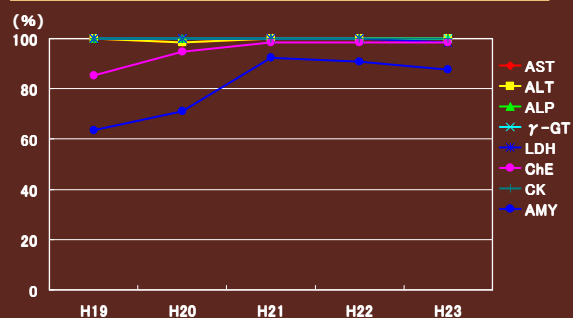


AMY 基質別施設数

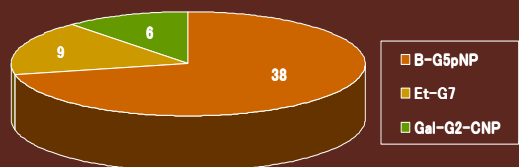


AMY 基質と試薬メーカー

B-G5pNP	シスメックス、シノテスト、ニットウボウ、和光純薬
Et-G7	シノテスト、デンカ生研、三菱化学メディエンス、ロッシュ
Gal-G2-CNP	関東化学、極東製薬、セキスイメディカル、東洋紡、ロッシュ

AMY 基質別測定値

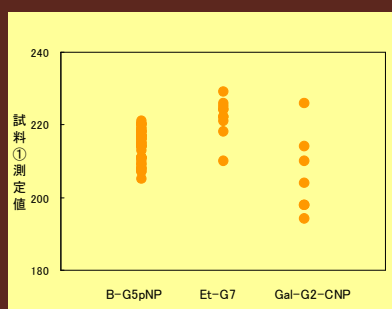


AMY 試薬メーカー別

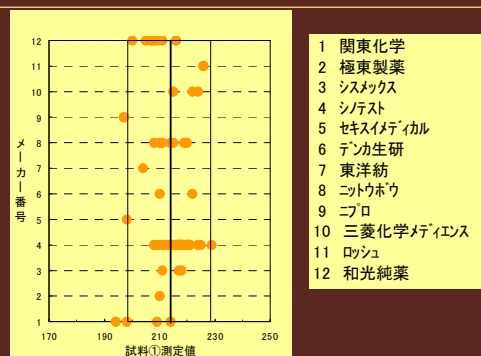

ChE 基質と試薬メーカー

P-ヒドロキシベンゾイルコリンヨウ素酸法(pHBC)	協和メデックス、シノテスト、セロテック、富士レビオ、ベックマンコールター、三菱化学メディエンス、和光純薬
ヨウ化2,3-ヒドロキシベンゾイルコリン(DMBT)	シスメックス

ChE メーカー別測定値

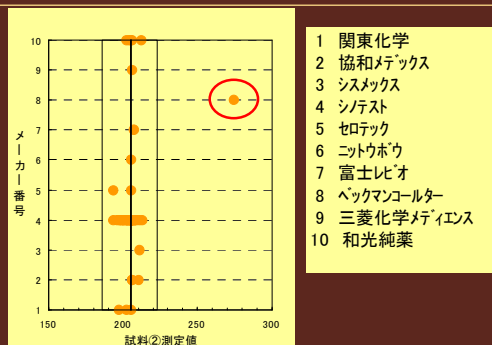

ChE 基質別測定値

